


PHILIPS


PHILIPS gereedschap
kan anderszins niet
gebruikt worden.
Alle rechten voorbehouden.

Philips gereedschap
kan anderszins niet
gebruikt worden.
Alle rechten voorbehouden.

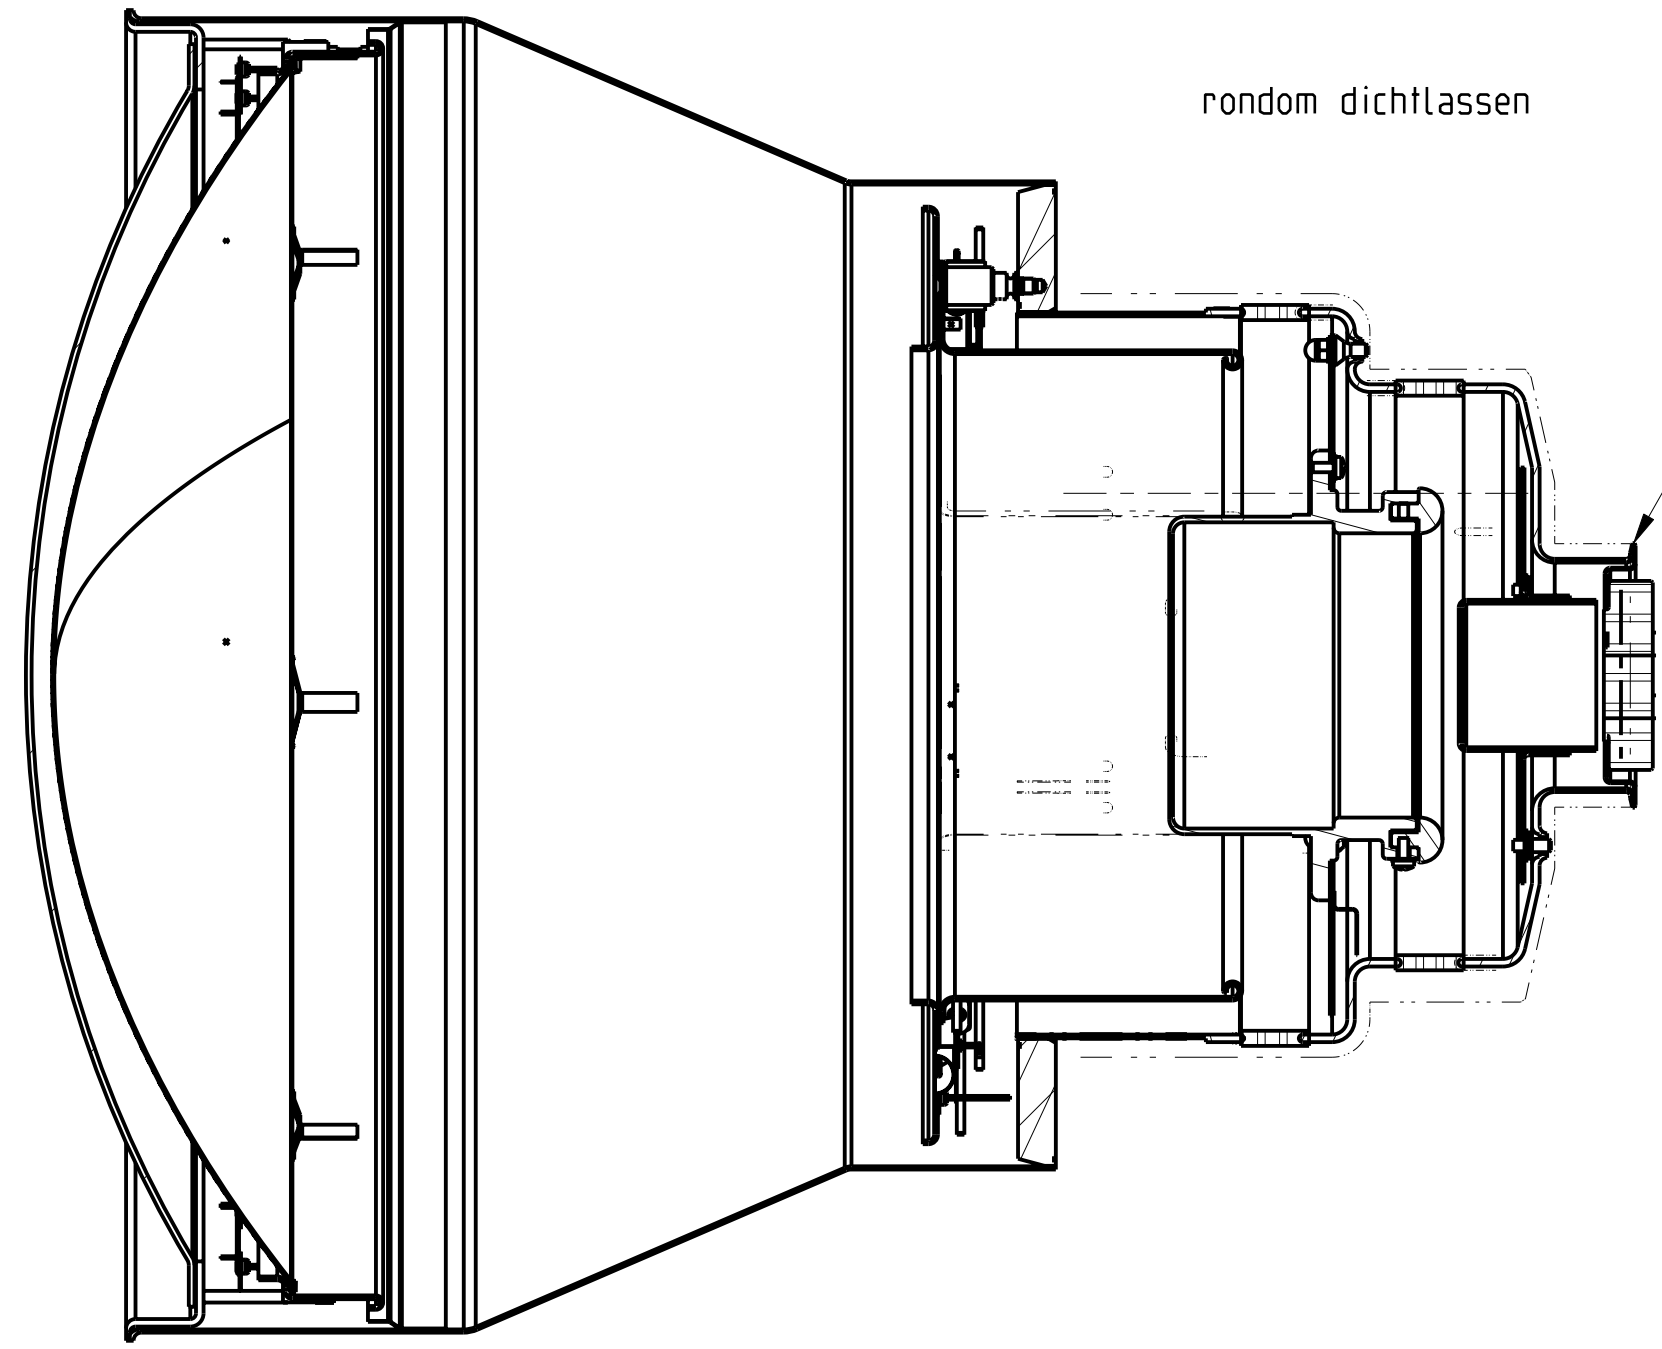


rondom dichtlassen

rondom dichtlassen

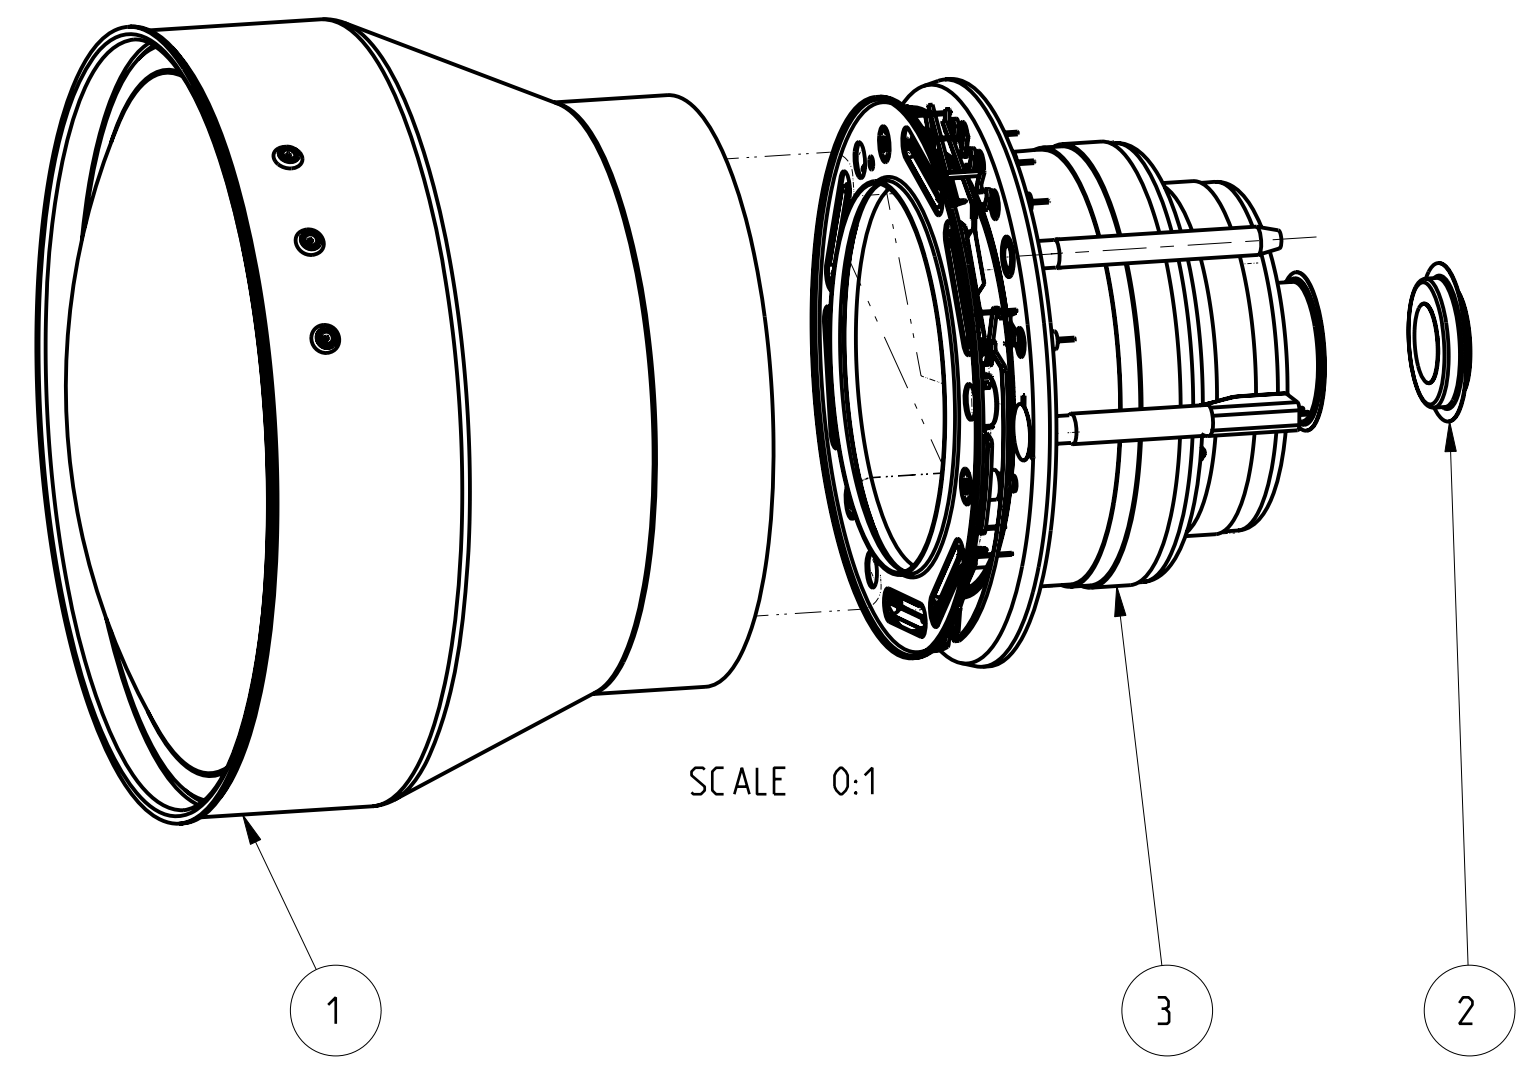

SCALE 0:1

Bij montage pompstengel
uitrichten t.o.v.
middelste doorvoer

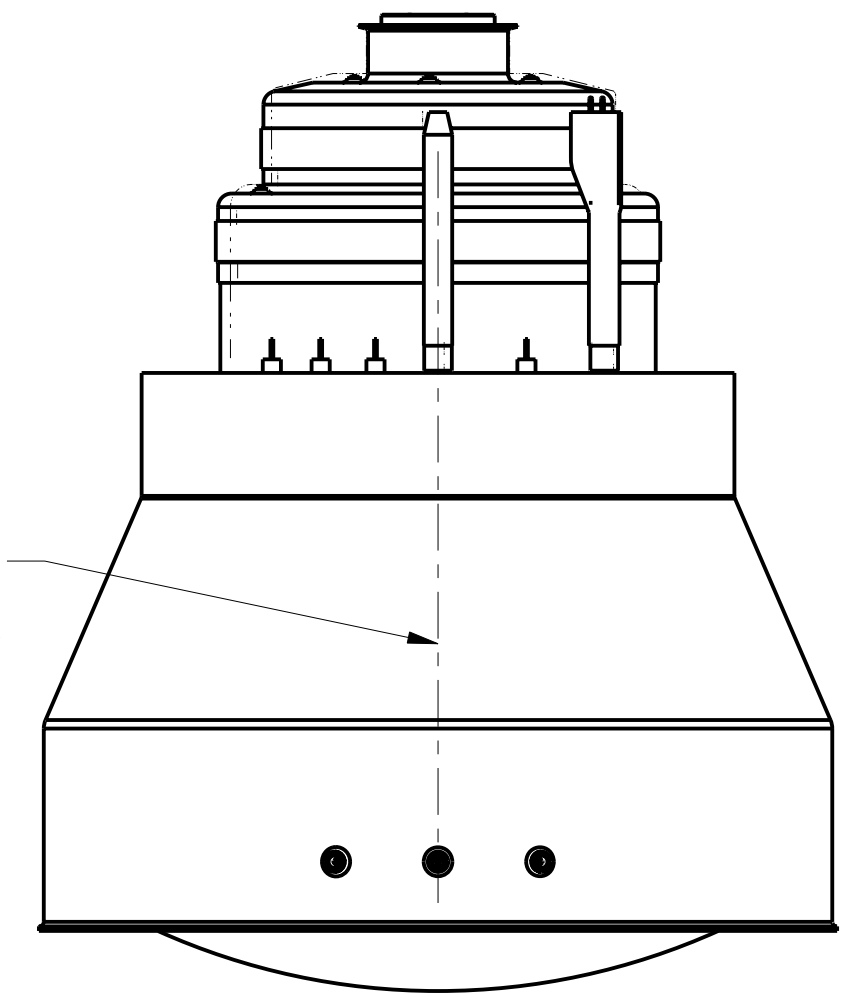

SCALE 0:1

	mm	±	± °		
1:1					
info only	Sam. buis a-a gelast		4522 151 6090	2	2003-02-01
	R. Kerckhoffs	8222 036 2948. I	110	2	A2
	0.		PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V..BEST		